

Số: 390./TB-BVMH

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời báo giá trang thiết bị y tế**

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh vật tư, y dụng cụ, thiết bị y tế.

Bệnh viện Mắt Huế đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn, cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Chức năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Ghi chú
1	Máy ly tâm	Máy	Bao gồm: 01 máy chính, Angle rotor: 12 x 15ml, adapter 5ml cho ống EDTA. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Thông số kỹ thuật: - Tốc độ ly tâm tối đa: $\geq 6.000$ vòng/phút, có thể tùy chỉnh thay đổi. - Lực ly tâm tối đa: $\geq 4427$ xg, có thể tùy chỉnh thay đổi. - Thể tích ly tâm tối đa: $\geq 6 \times 50$ ml - Khoảng tốc độ: tối thiểu từ 200 đến 6.000 vòng/phút, có thể tùy chỉnh thay đổi. - Nguồn điện: 230V, 50-60Hz Tính năng: - Phù hợp với tiêu chuẩn IVD, khóa nắp bằng điện, có thể thay đổi được các loại rotor khác nhau, tự động ngắt khi phát hiện hoạt động không cân bằng. - Độ ồn: $\leq 60$ dBA - Bảng điều khiển LCD, điều khiển và hiển thị đầy đủ các thông số.	01	Hàng hóa đảm bảo tính pháp lý theo quy định của Pháp luật
	<b>Tổng cộng: 01 khoản</b>				



Bệnh viện Mắt Huế xin thông báo và mời các doanh nghiệp quan tâm báo giá cung cấp.


Báo giá xin gửi về Bệnh viện Mắt Huế theo địa chỉ: Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Khoa Cận lâm sàng;
- Tổ truyền thông  
(đăng trên Website, Facebook bệnh viện);
- Lưu: VT, TC-KT, Dược.

**GIÁM ĐỐC**

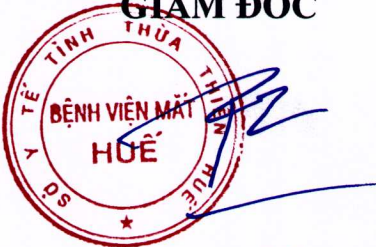

*BS. Phạm Minh Trường*

